

Universitätsklinikum Halle (Saale) | Postfach | 06097 Halle (Saale)

An alle Einrichtungen

ZentrallaborÄrztliche Leiterin:
Dr. Beatrice Ludwig-Kraus

Ihre Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen

Datum

08.01.2018

Hausanschrift:Ernst-Grube-Str. 40
06120 Halle**Laborinformation
Zentrallabor****Sekretariat**

Tel.: (0345) 557 2370

Fax: (0345) 557 2355

E-Mail: zentrallabor@uk-halle.dewww.uk-halle.de/zentrallabor**Produktrückruf der Fa. Thermo Fisher Scientific zu den ImmunoCAP Allergenen c5 (Ampicilloyl) und c6 (Amoxicilloyl) aufgrund von Stabilitätsproblemen****Annahme und Rezeption**

Tel.: (0345) 557 2312

Betroffen sind alle Messungen von spezifischem IgE gegen c5 (Ampicilloyl) ab dem 22.05.2017 und alle Messungen von spezifischem IgE gegen c6 (Amoxicilloyl) ab dem 29.05.2017.


Die Testergebnisse können laut der Firmeninformation niedriger als der wahre Wert, oder falsch negativ ausgefallen sein.

Bis auf weiteres kann die Fa. Thermo Fisher Scientific derzeit keine Tests zur Messung der spezifischen IgE Konzentration gegen c5 (Ampicilloyl) und c6 (Amoxicilloyl) liefern.

Proben, bei denen das spezifische IgE gegen c5 (Ampicilloyl) oder c6 (Amoxicilloyl) bestimmt werden soll, werden so lange mittels Fremdversand zu einem Labor, das mit einem anderen Testanbieter arbeitet, versendet.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Zentrallabors gerne zur Verfügung.

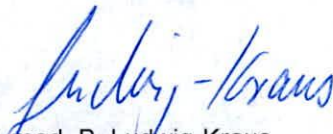

Dr. med. B. Ludwig-Kraus
Ärztliche Leiterin Zentrallabor